

Punta per ultrasuoni piezo per Impianti e per le ricostruzioni in ceramica e zirconia

La soluzione ideale per la gestione dei tessuti perimplantari




Il materiale della punta metallica IS Silver provoca deformazione sulla punta stessa, NON sulle superfici degli impianti o delle ricostruzioni in ceramica.

Unica in lega speciale per non graffiare la superficie implantare* o zirconia

* articoli scientifici a richiesta




La punta IS Silver è monouso

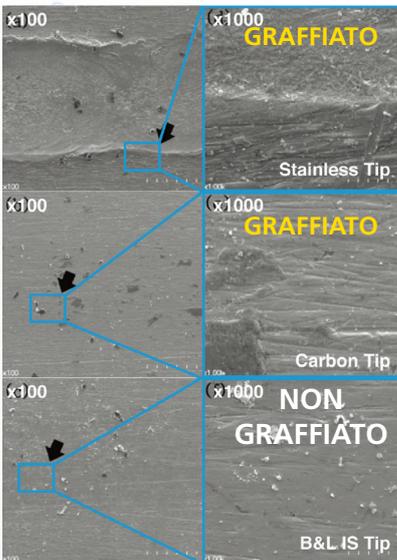


Perché scegliere la punta per Impianti IS Silver?

- Perché efficace ma allo stesso tempo assolutamente sicura per le superfici implantari lucide degli impianti
- Più sicura ed efficace delle curette per impianti di plastica o titanio
- Ideale per la rimozione completa del cemento residuo
- Compatibile con ablatori piezoelettrici con attacco europeo o americano

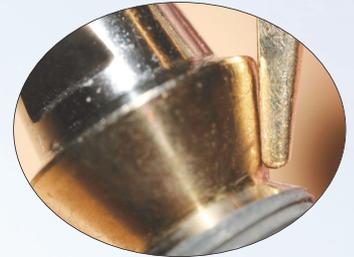


Appuntita

- Evita un'eccessiva apertura del solco gengivale

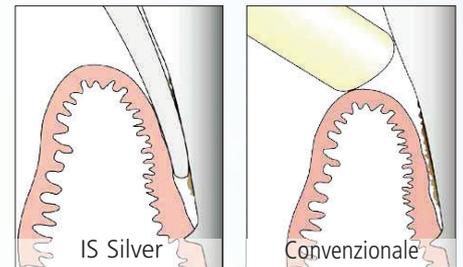

Accessibilità

- L'estremità piegabile della punta può essere sfruttata per raggiungere aree nascoste
- Fornisce un accesso più agevole alla gengiva disto-linguale dei molari

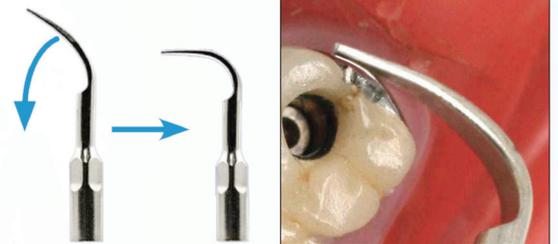

Indicazioni

- Ideale nella gestione parodontale degli impianti
- Ideale nel trattamento della perimplantite
- Ideale per la rimozione del cemento in eccesso

Reference: Hyon-Woo Seol, Seong-Joo Heo, "Effect of a new ultrasonic tip on several dental materials surface, the class of dental prosthesis". Dental school of Seoul National University, Korea
Articoli accettati per la pubblicazione su International Journal of Oral & Maxillofacial Implants e su Clinical Oral Implants Research.