


**Ricerca e Seleziona  
Qualità & Soluzioni  
per voi!**



**ANDRA  
GAUGE**

*"Quando i millimetri contano Andra Gauge è l'unica scelta"*

- Verticale
- Lato a Lato
- Antero/Posteriore

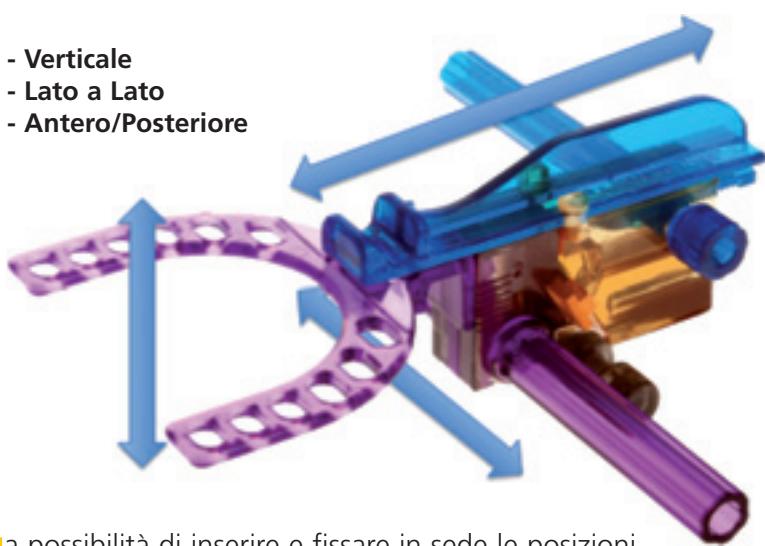

**L**a possibilità di inserire e fissare in sede le posizioni antero-posteriore e verticale fornendo allo stesso tempo un posizionamento preciso del movimento sagittale rende **Andra Gauge** il mezzo ideale per eseguire la miglior registrazione occlusale, precisa, accurata e riproducibile.

**Nominato nella Top Ten Most Wanted Lab Products del 2012, questo strumento unico nel suo genere garantisce i risultati estetici e funzionali migliori possibili con la creazione di uno schema preciso tra paziente, dentista e laboratorio.**

#### **Caratteristiche e Vantaggi**

- Misurazioni Sagittale, Verticale, Antero/Posteriore.
- Meno tempo alla poltrona.
- Elimina i costi ed i tempi di pulizia.
- Funziona con la maggior parte delle Filosofie e Modalità.
- Sicuro per la Radiologia.
- Monouso.
- Realizzato in durevole policarbonato.
- Resistente agli impatti, ed al calore.
- Ottima visibilità e contrasto.

#### **Ideale per la realizzazione di:**

- Dispositivi per l'apnea notturna.
- Splint/Bite per l'ATM.
- Splint/Bite per Bruxisti.
- Apparecchi ortodontici funzionali.

**Andra Gauge** viene utilizzato congiuntamente a polivinilsilossani per registrazioni occlusali (es. **Blu Mousse**).

Dispositivo mono-paziente imbustato igienicamente

**Andra Gauge** - l'unico per registrazioni occlusali regolabile su tutti e 3 gli assi



#### **Antero-Posteriore**

- 0 mm è da bordo a bordo.
- 5 mm posteriore
- 7 mm anteriore
- Range A/P totale 12 mm



#### **Sagittale**

- 0 mm è la linea mediana.
- 3 mm a sinistra
- 3 mm a destra



#### **Verticale**

- 2 mm minimo verticale.
- 7 mm di movimento verticale aggiuntivo.
- Range Verticale totale 9 mm

**19 76101 Andra gauge 1 pz. € 48,00**

**19 76106 Andra gauge Econopak 6 pz. € 124,50**



**1.** Allineare la linea mediana del paziente per assicurare un adattamento confortevole e ridurre gli effetti dell'ATM dovuti ad un impiego a lungo termine del dispositivo da realizzare.



**2.** Inserire le posizioni antero-posteriore, verticale e sagittale desiderate. Rimuovere Andra Gauge e fissare le posizioni.



**3.** Dopo aver bloccato Andra Gauge nella posizione corretta, applicare il materiale per la registrazione occlusale (p. es. Blu-Mousse).



**4.** Chiedere al paziente di chiudere nella posizione che avete stabilito.



**5.** Rimuovere Andra Gauge. Ora disponete di una perfetta **registrazione occlusale 3D** da inviare al laboratorio. Grazie alla registrazione più accurata si evita ogni confusione permettendo una lavorazione più rapida e il bite più accurato.

*Per ottenere la MIGLIORE Registrazione Occlusale*

## Istruzioni d'uso

### Istruzioni per la regolazione intraorale

**STEP 1**



**Sagittale**



**Verticale**



**STEP 2**



Determinati i tre assi togliere Andra Gauge dalla bocca del paziente e bloccare le posizioni.


Oppure

### Istruzioni per la regolazione extraorale

**STEP 1**



**Sagittale**



**Verticale**



**STEP 2**



Selezionare e bloccare le posizioni Antero/Posteriore, Verticale e Sagittale desiderate (stabilite in base alla modalità preferita, es. radiologica, anatomica, elettrodiagnostica, faringometrica, ecc.).

Inserire Andra Gauge in bocca. Allineare il segno centrale della culla dentaria mascellare con la linea mediana dei denti mascellari superiori. Porre i denti anteriori nella culla dentaria mandibolare. Rimuovere A. G.

**STEP 3**



Applicare una piccola quantità di materiali per registrazione occlusale nello spazio formato tra le culle per i denti, mascellare e mandibolare. Attendere la presa del materiale per registrazione occlusale. (Questo fornisce supporto extra tra le culle superiore ed inferiore).

**STEP 4**



Applicare il materiale per registrazioni occlusali sulle superfici superiore ed inferiore sella forchetta occlusale. Applicare abbastanza materiale per registrazioni occlusali da compensare per la posizione verticale desiderata sulla porzione superiore della forchetta occlusale.

**STEP 5**



Inserire nella bocca del paziente iniziando dall'arca superiore. Allineare il segno centrale della culla mascellare alla linea media anteriore superiore. Far chiudere i denti inferiori nella culla per i denti mandibolari. Tenere fino a quando il materiale di registrazione fa presa.

**STEP 6**



Rimuovere Andra Gauge.



**IVAN ILIC' S.r.l.**

Via L. Muratori, 46/11 - 20135 Milano (Italy)

TEL: +39 02 55 016 500 - 02 36 512 990

[ilic@ilicdental.com](mailto:ilic@ilicdental.com) | [www.ilicdental.com](http://www.ilicdental.com)

\* Per accomodare i denti mandibolari affollati o sovrapposti, si possono eseguire leggeri ritocchi alla culla dentale mandibolare utilizzando una fresa stretta per resine acriliche (p. es. Shofu 138).